

調製済み試薬パック

流れ分析用の試薬パックは調製済みで提供されます。利用者が試薬を自分で調製する必要がなく、使用前の準備作業を軽減します。




対応する測定項目と使用方法は付属の説明書をご確認ください。

ユーザーの導入現場

湛江农科院

湛江农科院における流れ分析装置の現場写真。

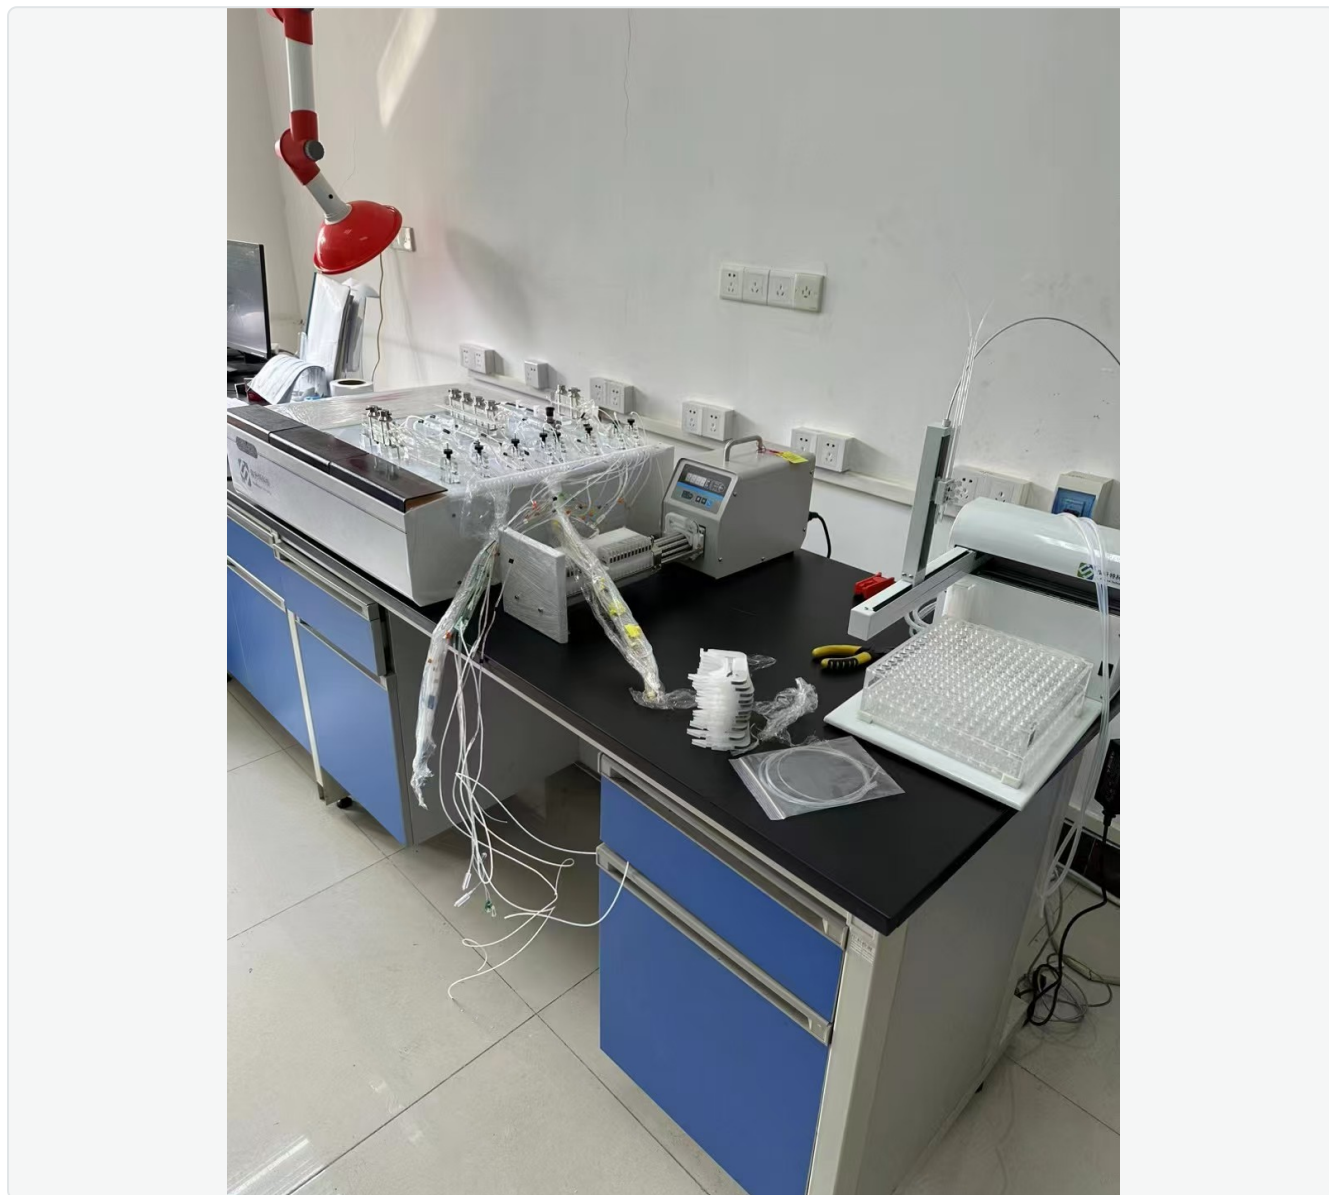

CFA-3000

洛阳烟草研究院

洛阳烟草研究院における CFA-3000 の使用現場。



洗浄槽

CCTV-1 / 00:11

CCTV『新聞聯播』の報道映像

CCTV『新聞聯播』の報道に映る実験室の装置。



報道映像の抜粋・00:11

動画は PDF の添付ファイルと、別途 MP4 ファイルで提供しています。

CCTV-XinwenLianbo-11s.mp4・960 × 448・11.000 s