


ชุดน้ำยาที่เตรียมไว้ล่วงหน้า

ชุดน้ำยาสำหรับการวิเคราะห์แบบไหลผ่านได้รับการเตรียมไว้แล้ว ผู้ใช้ไม่ต้องผสมน้ำยาเอง ช่วยลดงานเตรียมก่อนใช้งาน

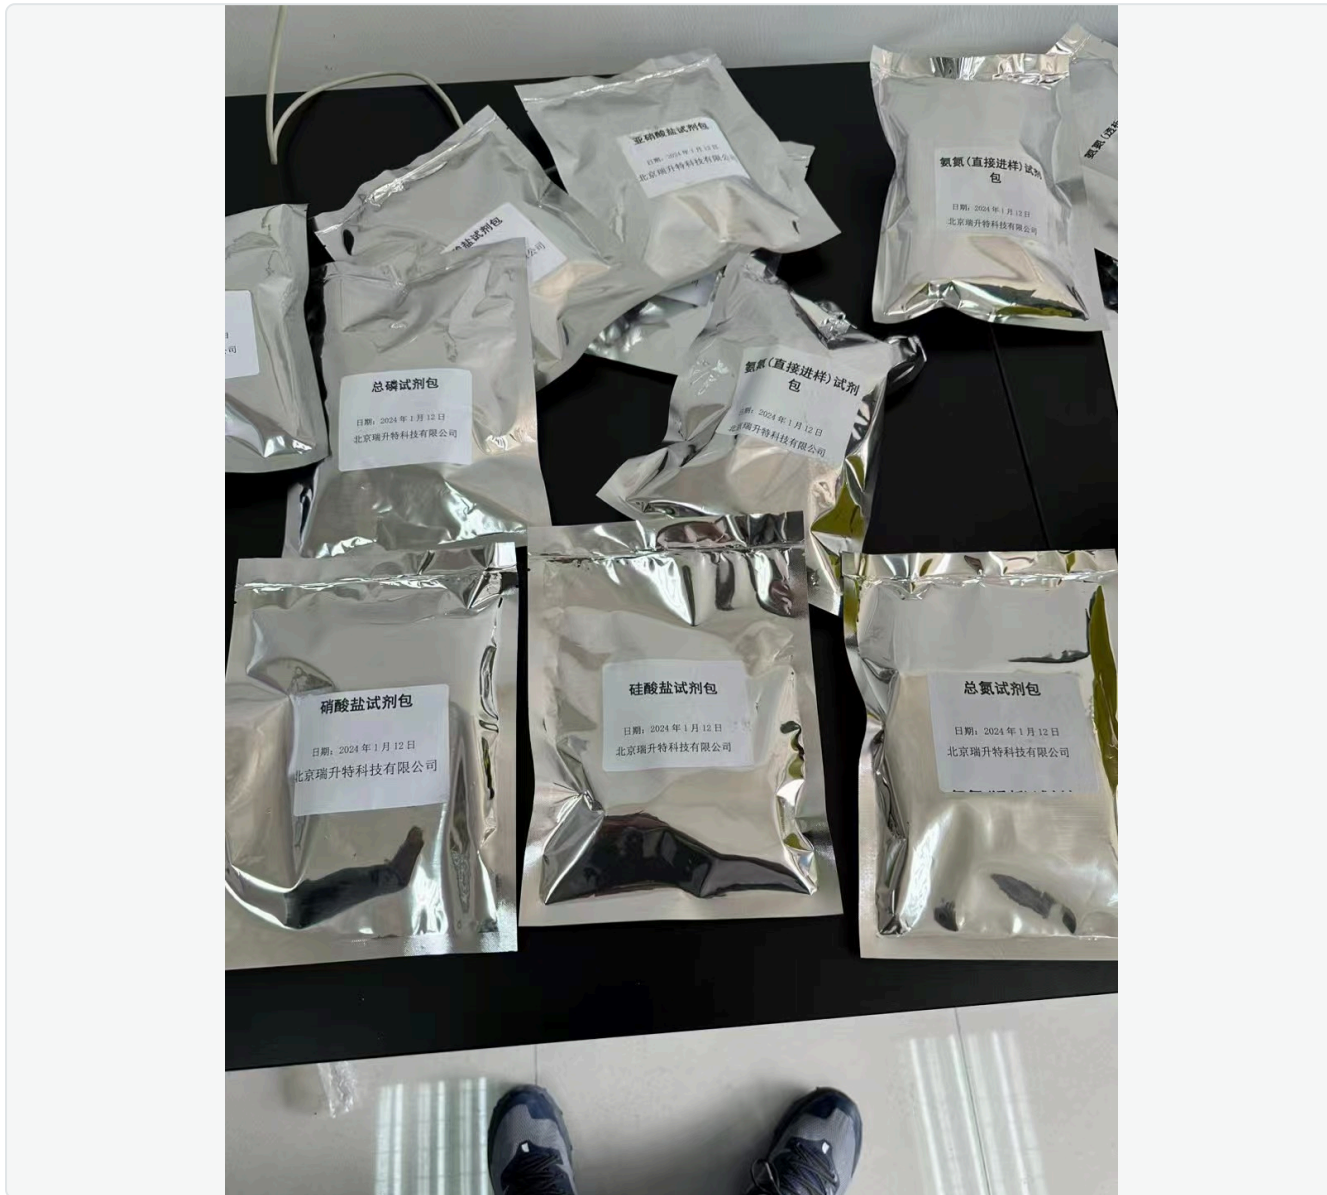


โปรดดูรายการทดสอบที่รองรับและวิธีใช้ในคู่มือที่ให้มาด้วย

การใช้งานในห้องปฏิบัติการของลูกค้า

湛江农科院

ภาพอุปกรณ์วิเคราะห์แบบไหลผ่านที่ 湛江农科院 หน่วยงานวิจัยการเกษตรจ้านเจียง

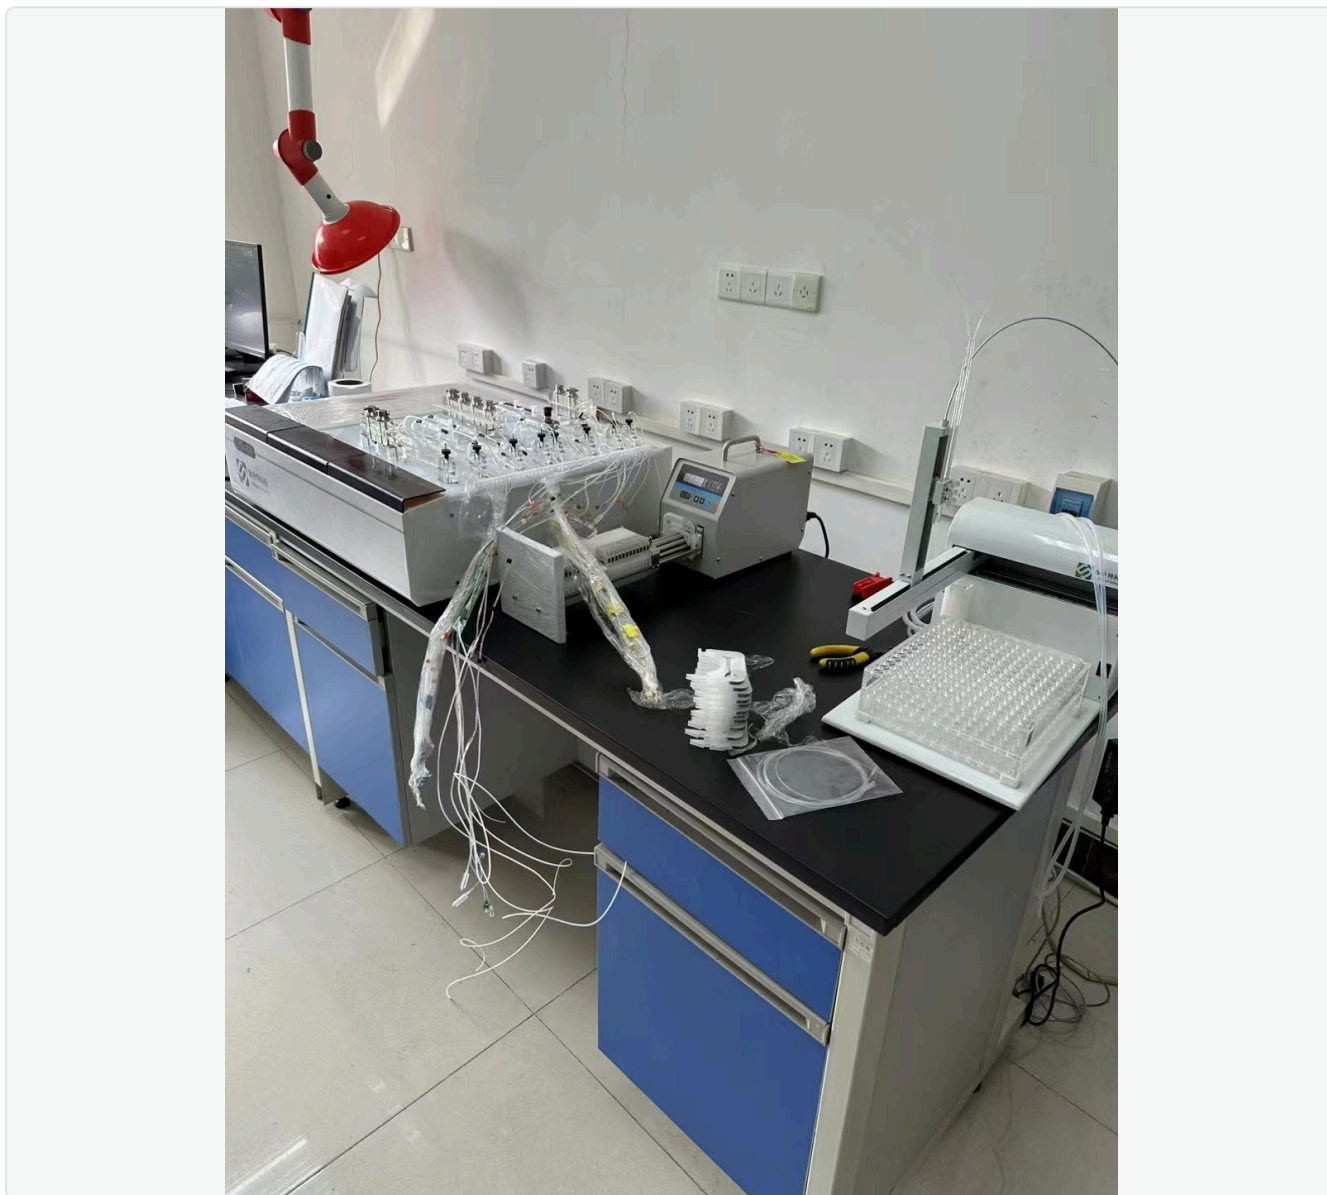

CFA-3000

洛阳烟草研究院

การใช้งาน CFA-3000 ที่ 洛阳烟草研究院 หน่วยงานวิจัยยาสูบสัวหยาง



อ่างล้าง

CCTV-1 / 00:11

คลิปข่าว Xinwen Lianbo ของ CCTV

ภาพอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการในรายงานข่าว Xinwen Lianbo ของ CCTV



คลิปข่าว · 00:11

วิดีโอแนบอยู่ใน PDF และมีไฟล์ MP4 แยกให้ด้วย

CCTV-XinwenLianbo-11s.mp4 · 960 × 448 · 11.000 s