


Gói thuốc thử pha sẵn

Gói thuốc thử cho phân tích dòng đã được pha sẵn; người dùng không cần tự pha chế, giúp giảm công việc chuẩn bị.

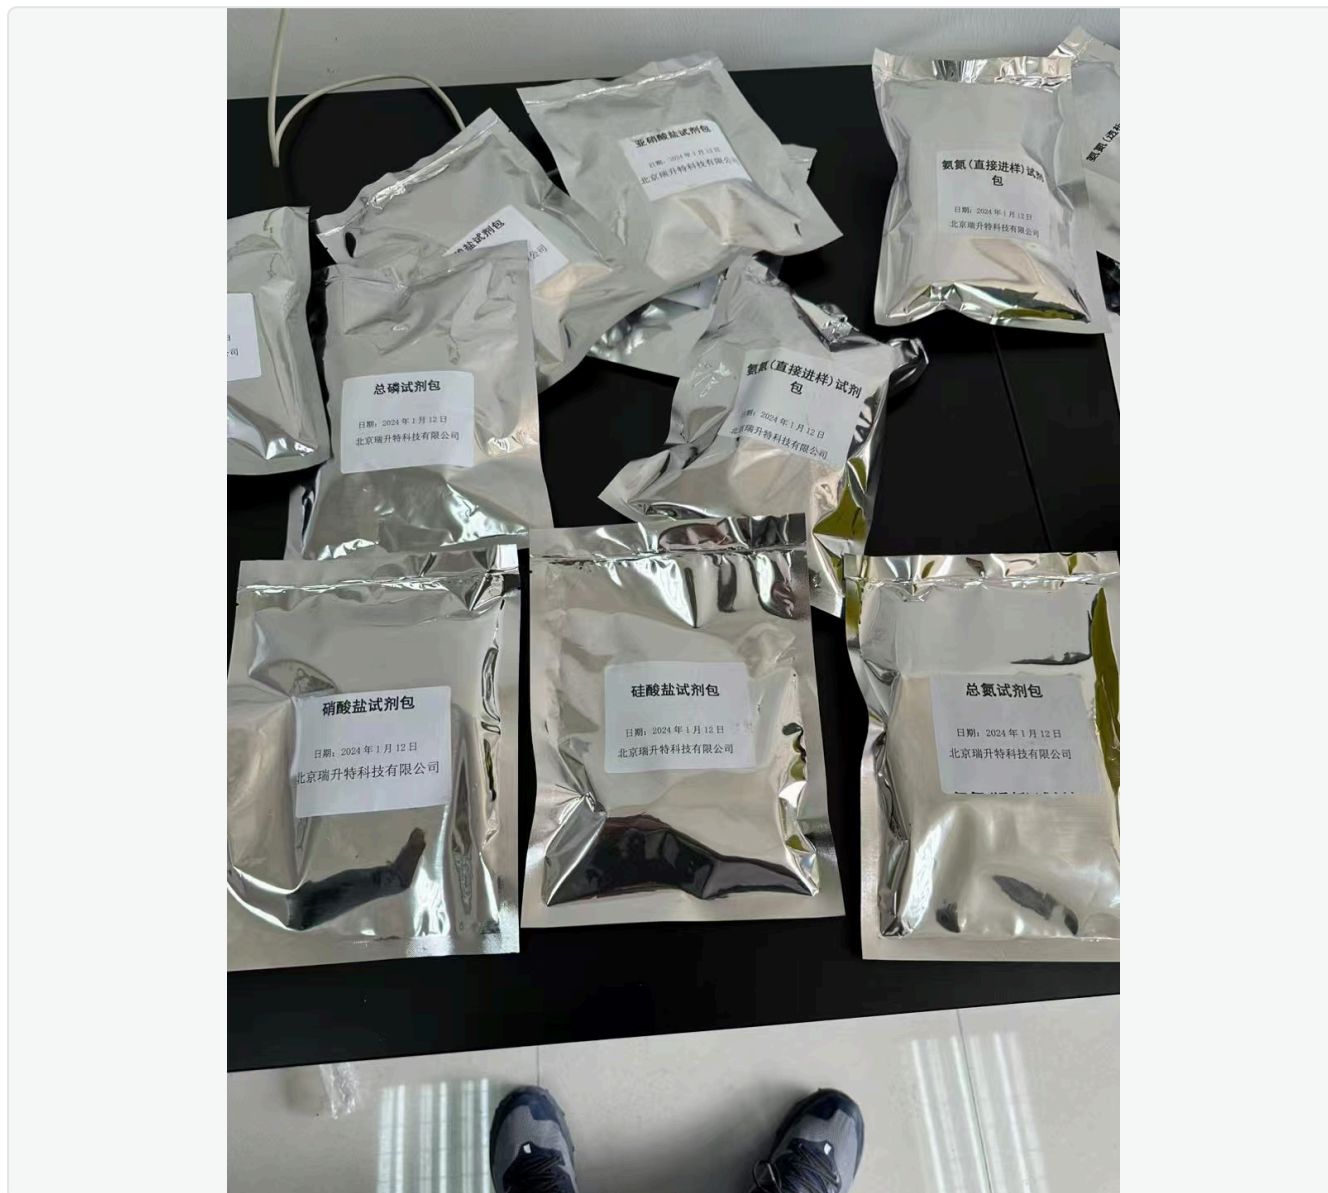


Xem hướng dẫn đi kèm về phép thử phù hợp và cách sử dụng.

Ứng dụng tại phòng thí nghiệm khách hàng

湛江农科院


Thiết bị phân tích dòng tại 湛江农科院, cơ sở nghiên cứu nông nghiệp Trạm Giang.

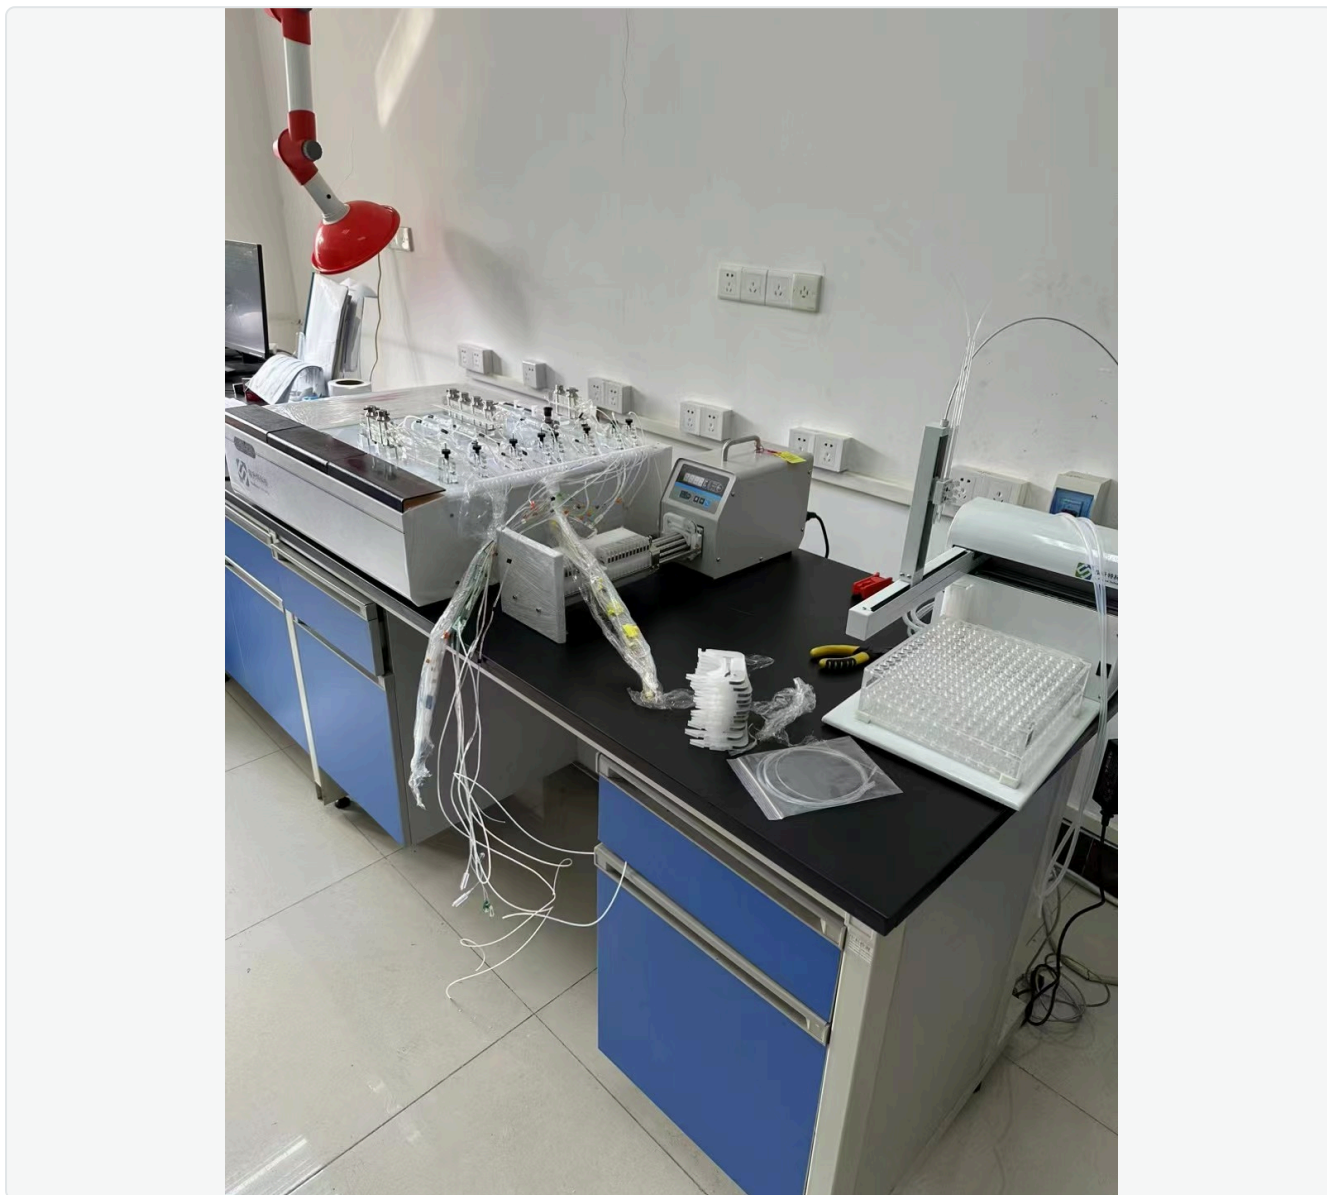

CFA-3000

洛阳烟草研究院

CFA-3000 được sử dụng tại 洛阳烟草研究院, cơ sở nghiên cứu thuốc lá Lạc Dương.

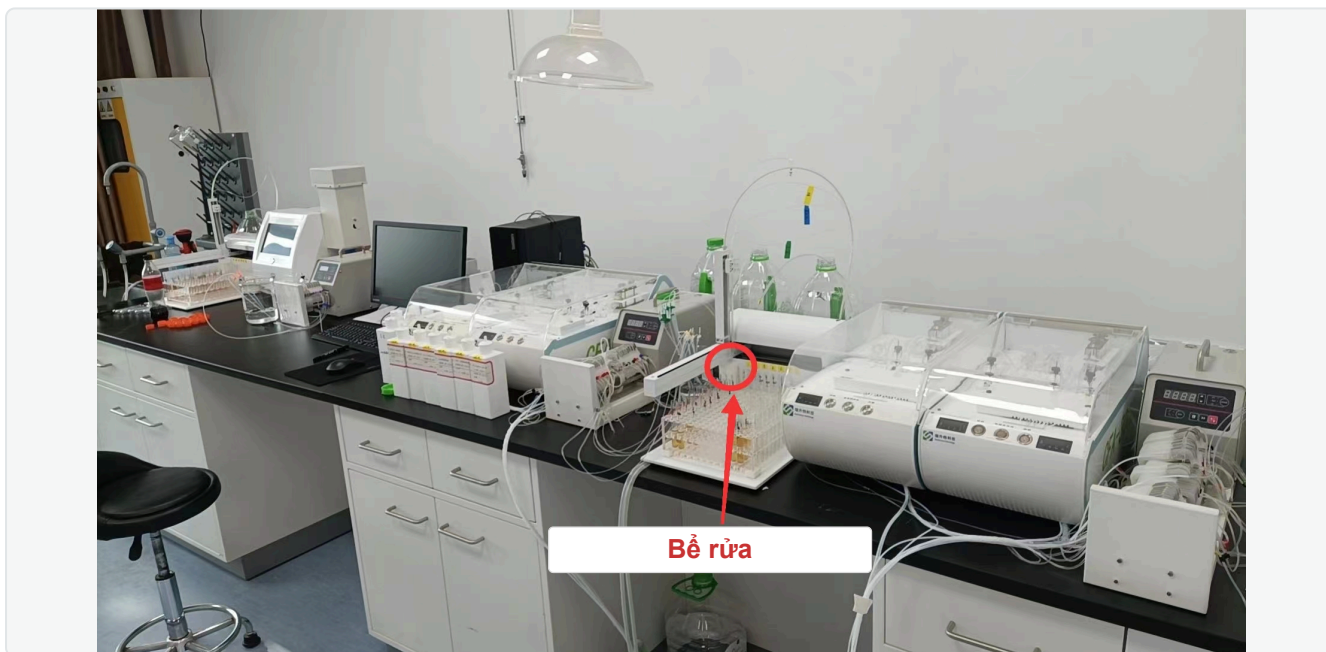

Bể rửa

CCTV-1 / 00:11

Trích đoạn bản tin Xinwen Lianbo của CCTV

Hình ảnh thiết bị phòng thí nghiệm trong bản tin Xinwen Lianbo của CCTV.



Trích đoạn bản tin · 00:11

Video được đính kèm trong PDF và cung cấp riêng dưới dạng MP4.

CCTV-XinwenLianbo-11s.mp4 · 960 × 448 · 11.000 s