


预配试剂包，使用更方便

流动分析配套试剂包已完成配制，用户无需自行手动配制，减少使用前的准备工作。

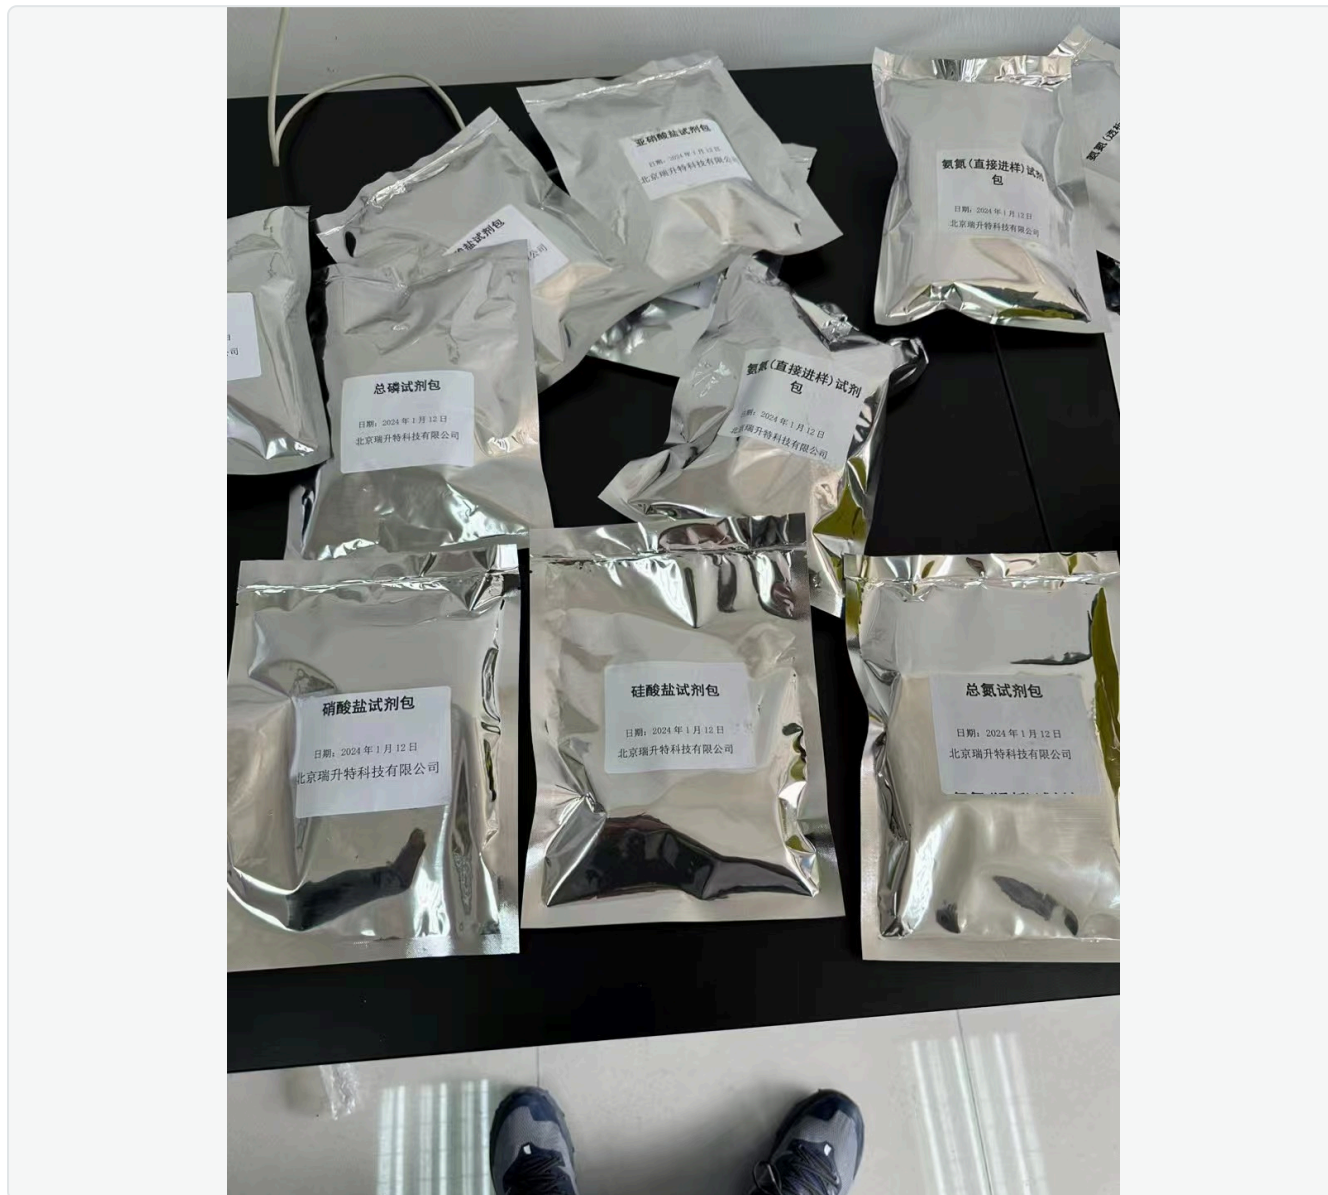


适用检测项目及使用方式以配套说明为准。

用户应用现场

湛江农科院


湛江农科院的流动分析设备现场照片。

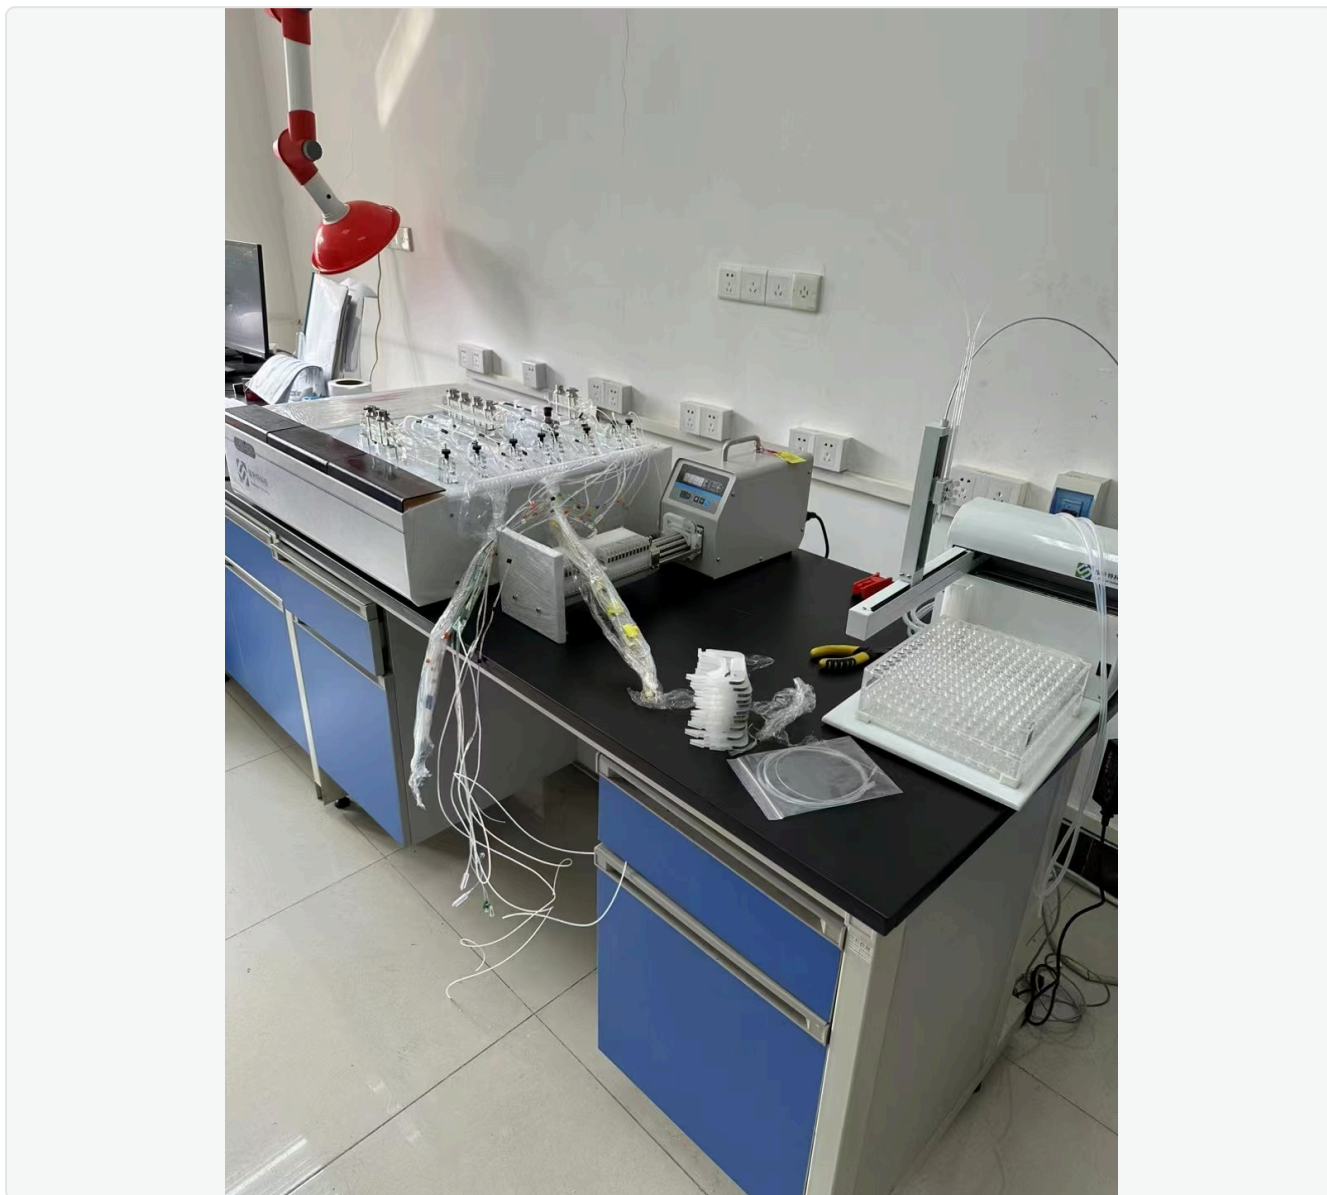

CFA-3000

洛阳烟草研究院

洛阳烟草研究院使用 CFA-3000 的实验室现场。

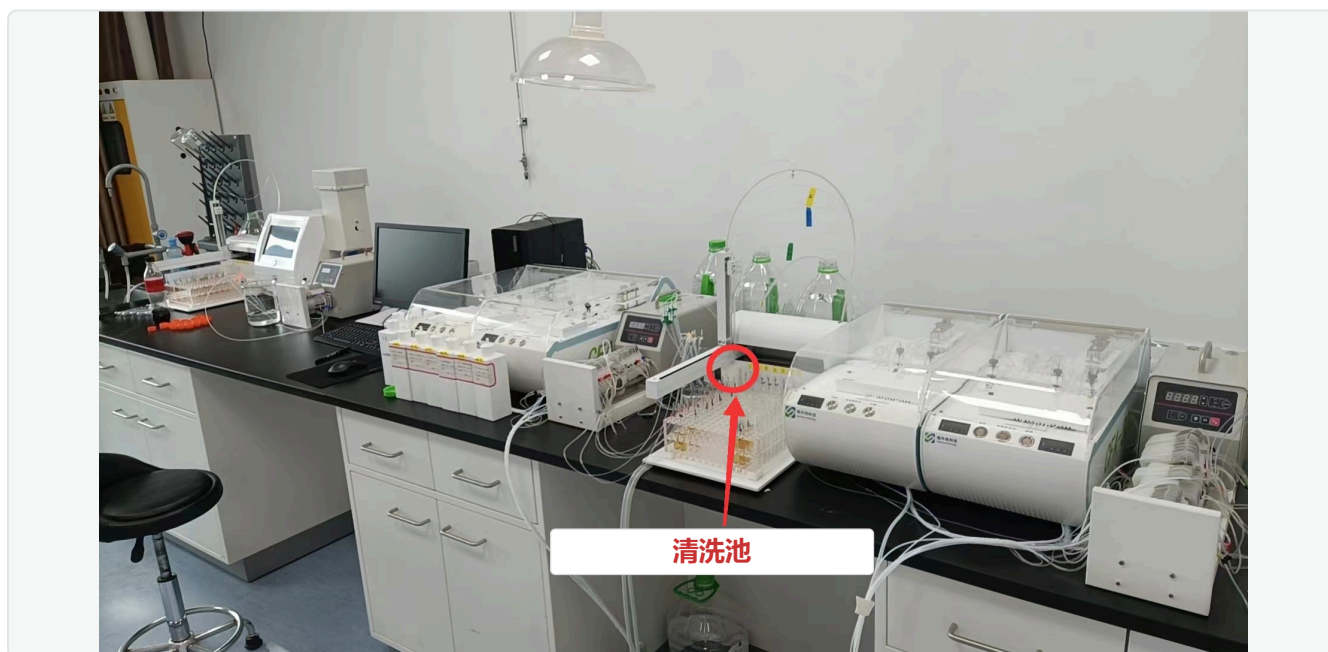

清洗池

CCTV-1 / 00:11

央视《新闻联播》报道片段

实验室设备在央视《新闻联播》报道中的画面。



报道片段 · 00:11

视频作为 PDF 附件随册提供，也可播放配套 MP4 文件。

CCTV-XinwenLianbo-11s.mp4 · 960 × 448 · 11.000 s